

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3

Postępowanie nr: 2020-876

DOTYCZY: Zadanie nr 7 A

do pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wyposażony w monitor o przekątnej 21,5 cala, w którym obraz diagnostyczny wypełnia 50% powierzchni ekranu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

do pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który nie posiada funkcji duplikowania obrazu diagnostycznego z monitora na panel dotykowy - co miałoby ułatwiać wykonywanie biopsji i wkłuc - mając na względzie, że aparat ma być wyposażony tylko w sondę sektorową do badań kardiologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

do pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wyposażony w twardego dysku o pojemności 500GB, na którym obrazy zapisywane są w formacie RawDicom, ale z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki w formatach jpeg, avi i dicom?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

do pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który nie posiada manualnej regulacji wzmocnienia poprzecznego LGC, ale w którym wzmocnienie to jest nastawiane automatycznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

do pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, w którym zakres regulacji wielkości bramki dopplerowskiej wynosi 1-16 mm, mając na względzie, że jest to wystarczająca wartość w badaniach kardiologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

do pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który standardowo wyposażony jest w funkcję automatycznego ustawienia kąta korekcji, natomiast nie posiada możliwości rozbudowy o automatyczne ustawienie bramki dopplera w przekroju naczynia, mając na względzie, że aparat jest wyposażony tylko w głowicę kardiologiczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

do pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który umożliwia tworzenie własnych wzorów raportów, z możliwością eksportu raportu w formacie PDF na zewnętrzne komputery i nośniki pamięci, ale nie posiada narzędzia do tworzenia własnych raportów na zewnętrznych komputerach PC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

do pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który nie posiada możliwości rozbudowy o funkcję wgrywania obrazów z badań CT, MRI, PET i USG?

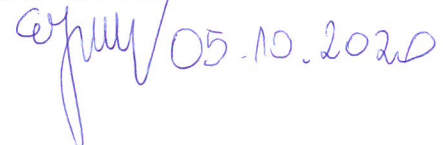
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

do pkt. 57

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę liniową o wymaganych parametrach obrazowania, ale posiadającą 168 kryształów piezoelektrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Ewa Januszaniec

 05.10.2020